


Kirurgi

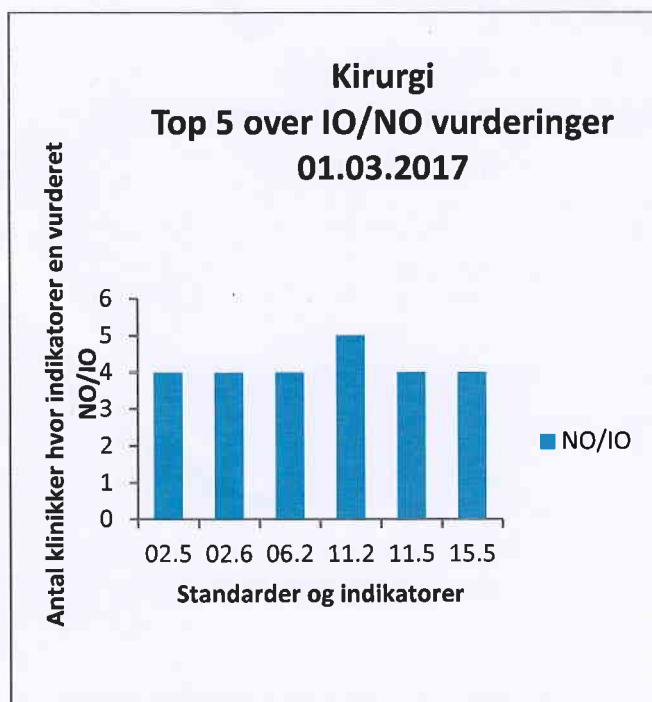

Standard 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling, indikator 5

I fire klinikker er der ikke gennemført journalaudit, hvor det undersøges, om diagnostik og behandling følger gældende retningslinjer.

Standard 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling, indikator 6

I fire klinikker er der ikke gennemført journalaudit, hvor det undersøges, om fravigelser fra retningsgivende dokumenter for diagnostik og behandling er angivet i patientjournalen.

Standard 06 Patientjournalen, indikator 2

Fire klinikker manglede at gennemføre journalaudit, hvor det undersøges, om patientjournalen indeholder data i henhold til gældende lovgivning.

Standard 11 Hygiejne, indikator, indikator 2

Rengøring og desinficering af medicinsk udstyr til flergangsbrug lever ikke op til krav i NIR i fem klinikker. Her består manglerne helt konkret i manglende desinficering før sterilisering.

note fra eKVIS: IKAS har i dec. 2016 præciseret kravene efter de har været i dialog med SSI. Ved semikritisk udstyr er det tilstrækkeligt med rengøring og efterfølgende tørsterilisation/autoklaving. Ved kritisk udstyr, der gennembryder hud/slimhinder eller lægges i sterilt område, skal der desinficeres mellem rengøring og sterilisation.

Standard 11 Hygiejne, indikator, indikator 5

Fire klinikker kunne ikke fremvise dokumenter, hvori det var beskrevet, hvordan klinikken håndterer særligt smittefarlige patienter. To af disse klinikker kunne heller ikke redegøre fyldestgørende for proceduren for håndtering af særligt smittefarlige patienter.

Standard 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling, indikator 5

Fire klinikker ikke har en plan for kompetenceudvikling.